KH
тест
carbonate hardness

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Тщательно взболтать флакон с реактивом.
2. Прополоскать мерный стаканчик тестируемой водой 2–3 раза.
3. Поместить в мерный стаканчик 5 мл тестируемой воды.
4. Добавлять реактив в мерный стаканчик по каплям, перемешивая содержимое круговыми движениями после каждой капли, пока цвет раствора не перейдёт от синего через зелёный к жёлтому.

- 1 капля = 1°dKH (карбонатная жёсткость воды, выраженная в немецких градусах).
- Мерный стаканчик после анализа тщательно промыть в проточной воде и высушить.
- Реактив хранить плотно закрытым в прохладном тёмном месте. Избегать нагрева и прямых солнечных лучей.

Карбонатная жёсткость KH является составной частью буферной системы воды, которая удерживает pH воды от опасных колебаний.

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

KH тест

carbonate hardness


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1

5–10 сек



2

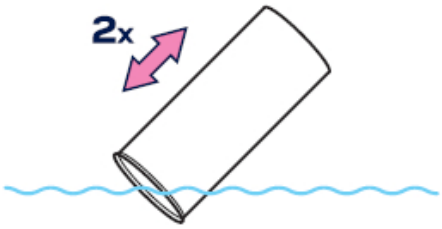

Прополоскать тестируемой водой

3



4



- Число капель реактива соответствует значению карбонатной жёсткости воды, выраженной в немецких градусах (°КН).
- Мерный стаканчик после анализа тщательно промыть в проточной воде и высушить.

GH тест

general hardness

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Тщательно взболтать флакон с реактивом.
2. Прополоскать мерный стаканчик тестируемой водой 2–3 раза.
3. Поместить в мерный стаканчик 5 мл тестируемой воды.
4. Добавлять реактив в мерный стаканчик по каплям, перемешивая содержимое круговыми движениями после каждой капли, пока цвет раствора не перейдёт от светло-розового/тёмно-розового/красного к зелёному. Переход цвета происходит быстро — от одной капли.

- 1 капля = 1°dGH (общая жёсткость воды, выраженная в немецких градусах).
- Мерный стаканчик после анализа тщательно промыть в проточной воде и высушить.
- Реактив хранить плотно закрытым в прохладном тёмном месте. Избегать нагрева и прямых солнечных лучей.

BWT

BEST WATER TECHNOLOGY

GH
тест
general hardness


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1

5–10 сек



2

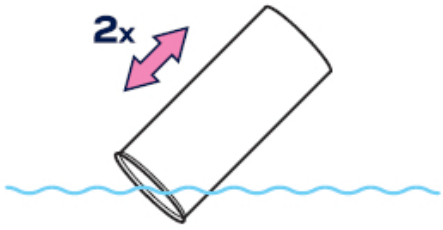


Прополоскать тестируемой водой

3



4

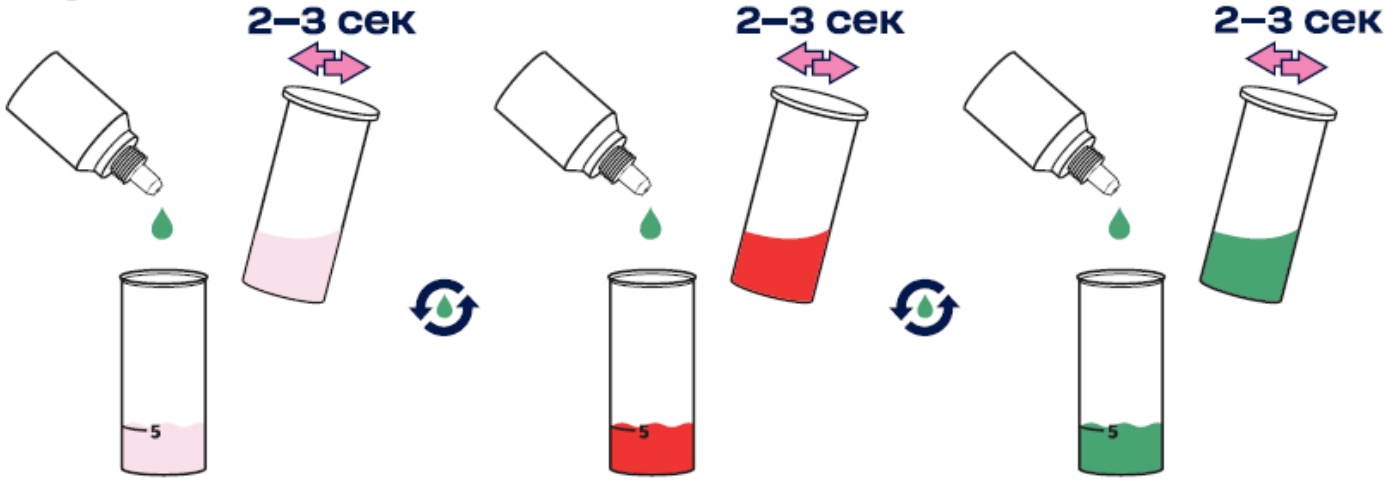

- Число капель реактива соответствует значению общей жёсткости воды, выраженной в немецких градусах (°GH).
- Мерный стаканчик после анализа тщательно промыть в проточной воде и высушить.